CODAN

IBPM

DPT-6000
(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®
(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Blodprøvetaking **NBSS^{XL}** –
Needle-free **B**lood **S**ampling
System (6ml)

CODAN

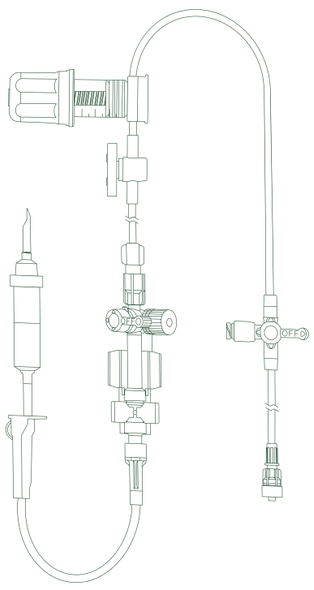

I. Forberedelse / fylling NBSS^{XL}

Set	Reservoar	SWAN Switch

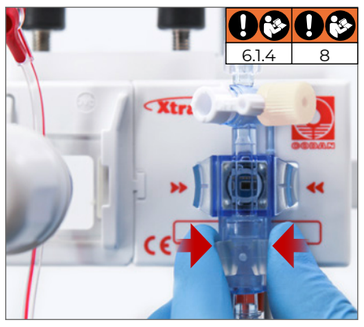

1 Fyll trykkmålingssettet.

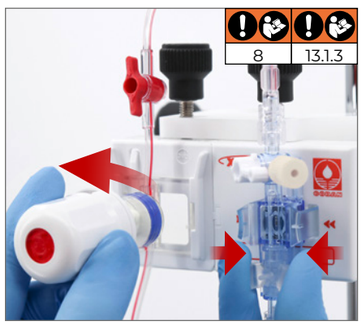

2 Under fylling åpne reservoaret langsomt opp 3/4 omdreining (270°) og vris så tilbake igjen.

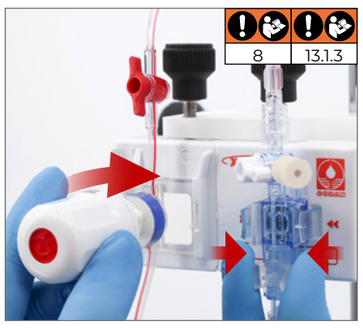

3 Fyll SWAN Switch fullstendig og fri for luftbobler.

4 Sett SWAN Switch i trykkmålingsposisjon.

II. Blodprøvetaking NBSS^{XL}

13.4.5

* Til dette anbefaler vi låsbare **Luer-lock-systemer**. Ved bruk av **Luer-slip-systemer** må du passe på at de kobles til svært forsiktig og med en **90°-dreiebevegelse** på sideutgangen.

1 Desinfiser prøvetakingsstedet. Ta hensyn til virketiden!

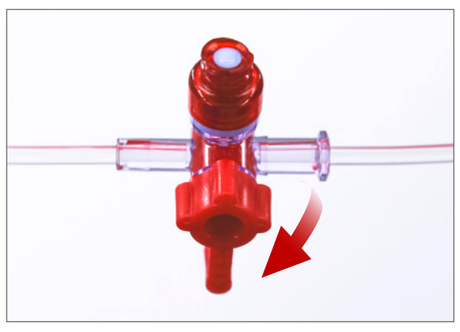

2 Sett SWAN Switch i skylleposisjon.

3 Steng 1-veiskranen.

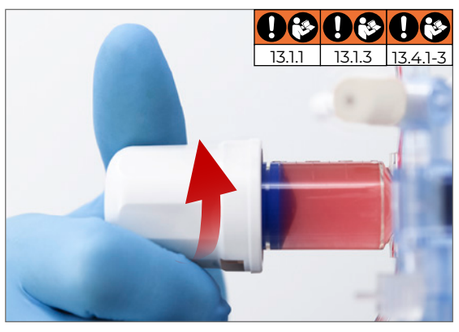

4 Åpne reservoaret langsomt helt opp mot venstre.

5 Koble til prøvetakingsbeholderen. *

6 Sett SWAN Switch i prøvetakingsposisjon. *

7 Uttak av blodprøven. *

8 Sett SWAN Switch i trykkmålingsposisjon. *

9 Koble fra prøvetakingsbeholderen. *

III. Reinfusjon og spyling

1 Vri reservoaret langsomt helt tilbake mot høyre.

2 Åpne 1-veiskranen.

3 Desinfiser prøvetakingsstedet.

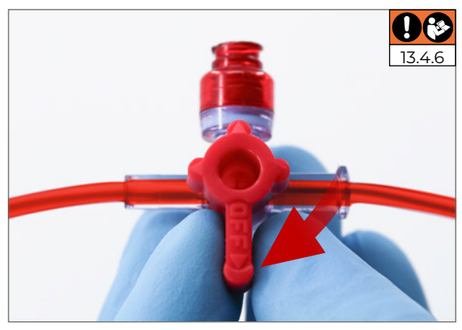

4 Sett SWAN Switch i skylleposisjon.

5 Skyll NBSS^{XL}.

6 Sett SWAN Switch i trykkmålingsposisjon.

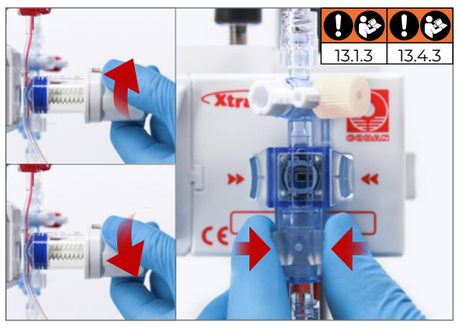

7 Åpne reservoaret langsomt opp 3/4 omdreining (270°) og vri tilbake igjen.

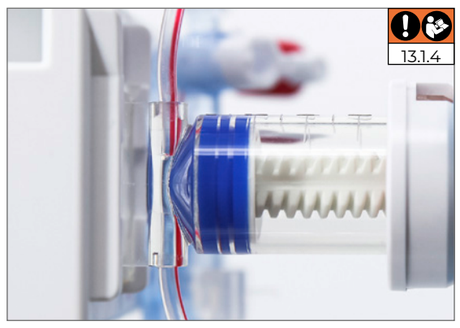

8 Visuell kontroll: Spyl inntil alle blodrester er fjernet.

9 Spyl NBSS^{XL}.

10 Kontroll: Kontroller trykkmålingen og visningen på skjermen.

Denne Quick Guide inneholder kort informasjon om de viktigste handlingstrinnene og erstatter ikke bruksanvisningen. Les og følg informasjonen om forskriftsmessig bruk samt advarsler og sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen. Informasjonen i handlingstrinnene tar utgangspunkt i tilhørende kapittel inkludert advarsler i bruksanvisningen. Dersom den ikke følges, er det stor sikkerhetsrisiko for pasient, bruker og tredjepart. Følg hygieneretningslinjene som gjelder på din institusjon.

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland

94.4552.01/2025-10