

I. Vorbereitung / Befüllung SWAN Switch

SWAN Switch



1 Druckmess-Set und SWAN Switch vollständig und blasenfrei befüllen.



2 SWAN Switch in Druckmess-Stellung bringen.

II. Blutentnahme SWAN Switch

* Für die Anwendung sind verriegelbare Luer-Lock Systeme empfohlen. Bei der Verwendung von Luer-Slip Systemen ist darauf zu achten, dass sie sehr vorsichtig und mit einer 90°-Drehung am Seitenabgang angeschlossen werden.



1 Entnahmestelle desinfizieren. Einwirkzeit beachten!



2 Entnahmebehälter fest konnektieren.*



3 SWAN Switch in Entnahmestellung bringen.*



4 Aufziehen des Mischbluts.*



5 SWAN Switch in Druckmess-Stellung bringen.*



6 Entnahmebehälter dekonnektieren und entsorgen.*



7 Neuen Entnahmebehälter fest konnektieren.*



8 SWAN Switch in Entnahmestellung bringen.*



9 Aufziehen der Blutprobe.*



10 SWAN Switch in Druckmess-Stellung bringen.*



11 Entnahmebehälter mit Reinblut dekonnektieren.*



12 Entnahmestelle desinfizieren. Einwirkzeit beachten!

III. Spülen




1 SWAN Switch in Spül-Stellung bringen.



2 SWAN Switch spülen.



3 SWAN Switch in Druckmess-Stellung bringen.

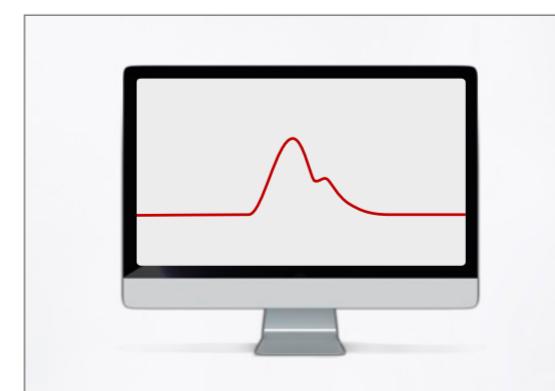

4 Kontrolle: Druckmessung & Anzeige am Monitor prüfen.



Dieser Quick Guide informiert Sie über die wichtigsten Handlungsschritte und ersetzt nicht das Beachten der Gebrauchsanweisung. Beachten und befolgen Sie unbedingt die Informationen über den bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie die Warn- und Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Die Hinweise in den Handlungsschritten beziehen sich auf das zugehörige Kapitel und die jeweiligen Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung. Bei Nichtbeachten/-befolgen bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken für den Patienten, Anwender und Dritte. Beachten Sie die Hygienerichtlinien Ihrer Einrichtung.